


Михаил Маркович, добрый вечер. Прочла внимательно пояснения к монитору 03_PX142...2656, ряд вопросов остались.



1) 13:33:20; 15:48:34,20:28:47 и др. с короткой АВ-задержкой после ЖЭ/с, за которой следует з.Р пример работы алгоритма PVC Respons - ответ стимулятора на желудочковую экстрасистолу.

2) Если в 07:46:51 стимул считается нереализованным

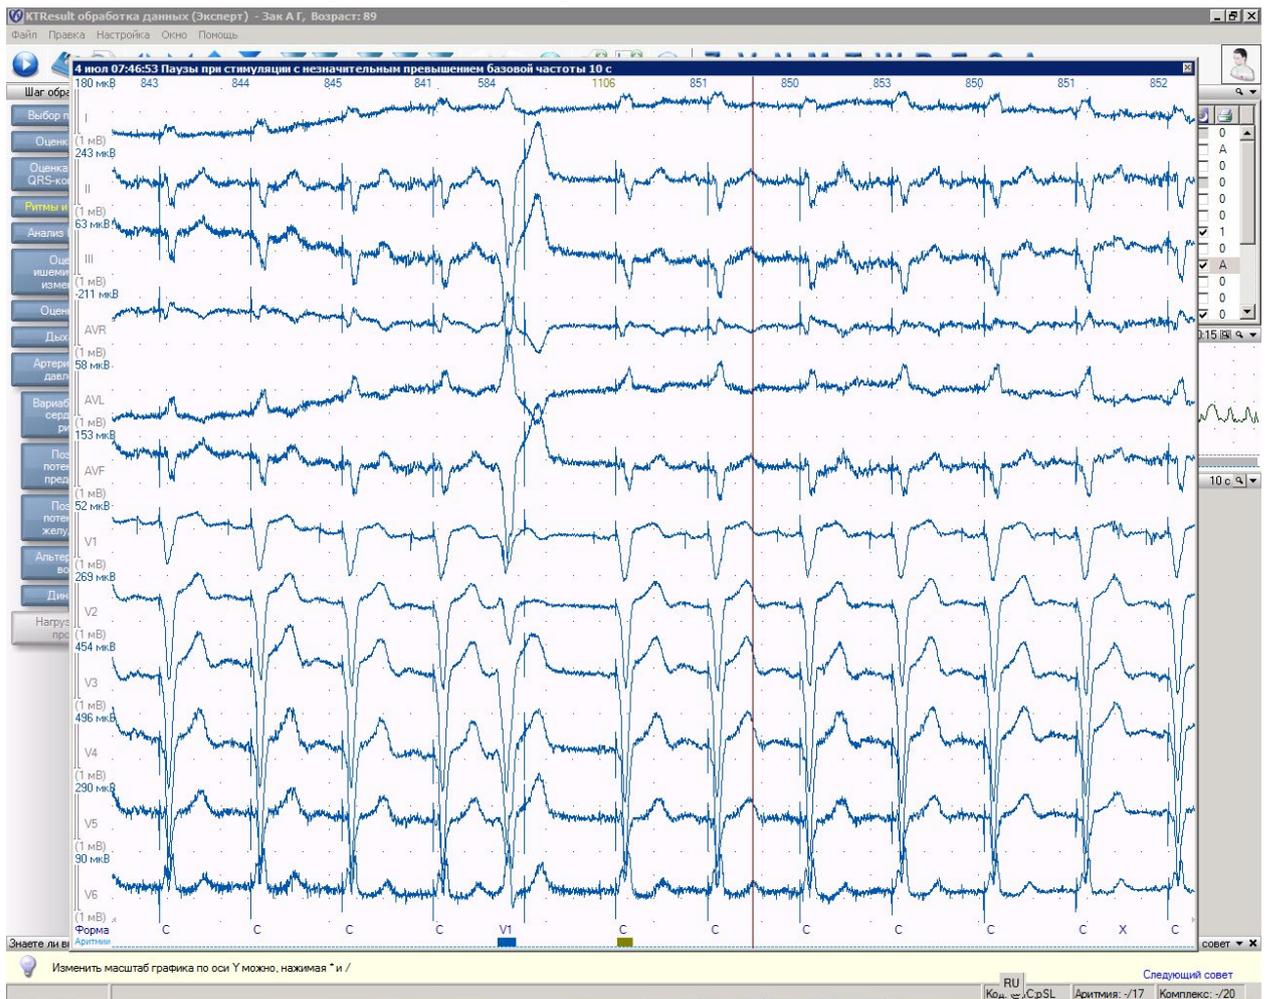


07:46:51

В 07:46:51 на ЭКГ регистрируется нереализованный стимул (единственный за все время наблюдения). С чем связано его появление?

1. С гиперсенсингом по предсердному электроду
2. С гипосенсингом по желудочковому электроду
3. **С совпадением по времени предсердного стимула и желудочковой экстрасистолы**
4. С работой алгоритма страховочной стимуляции желудочков

Как тогда расценить в 20:37:37, как второй нереализованный стимул, совпадающий с ЖЭ/с?

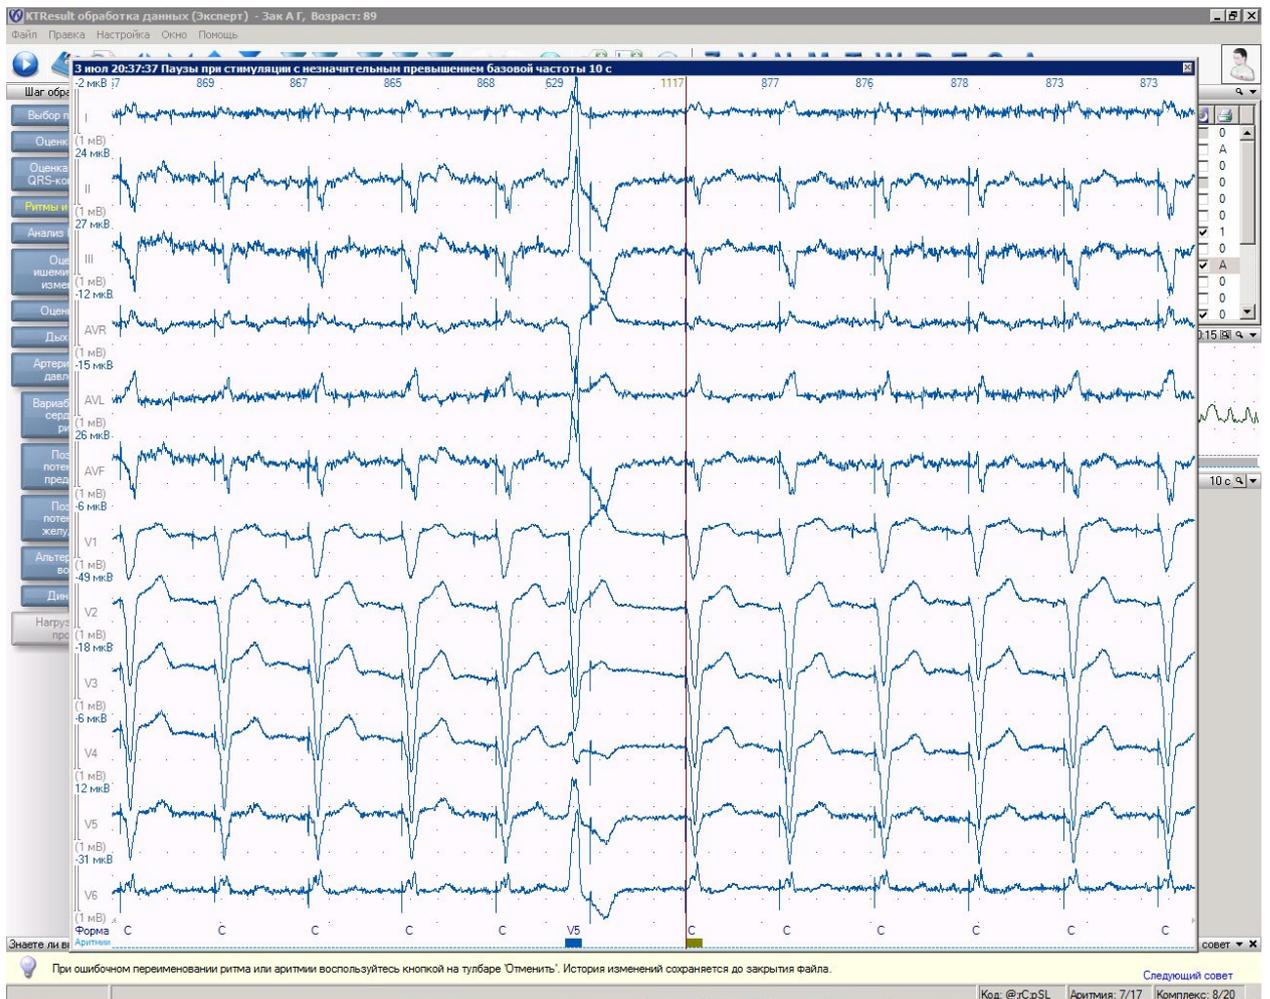

20:37:37

3) В этом примере 19:42:08 артефакт стимула наносится в уязвимую фазу, это важно отмечать? Пауза связана с гиперсенсингом по предсердному каналу?

